

南宁市第二妇幼保健院技术参数论证签到表

	工作单位	职务、职称	联系电话	姓名
论证专家	南宁市第二人民医院	副主任医师	13317712888	朱庆寿
	南宁市第五人民医院	副主任医师	13877104830	梁德敏
	南宁市第三人民医院	副主任医师	18507881762	刘峰
	南宁市第一人民医院	主任医师	13878102666	曾波
	广西中医药大学一附院	主任医师	13788683030	李强
监督人员	南宁市第二妇幼保健院	审计	13878818785	黄法慧
	南宁市第二妇幼保健院	纪检监察室干事	13878879628	陆志华

时间：2024年03月22日

认知图形插板

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：500.00 元

论证专家签字：朱诗 曾波 梁立帆 刘峰 李锡

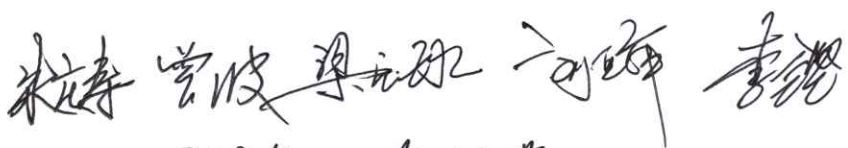
监督小组签字：黄法萱 陆庆华

时间：2024年3月22日

认知功能评估工具包

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：500.00 元

论证专家签字：

监督小组签字：

时间：2024年3月22日

护理床（带床垫 55 厘米高）

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：2500.00 元

论证专家签字： 

监督小组签字： 

时间：2024 年 3 月 22 日

助行器

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：145.00 元

论证专家签字：

监督小组签字：

时间：2024年3月22日

拐杖

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：40.00 元

论证专家签字：朱诗 曾波 梁立斌 刘峰 李锐

监督小组签字：陆培华 黄洁莲

时间：2024年3月22日

标准座椅

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：200.00 元

论证专家签字：


监督小组签字：

时间：2024年3月22日

餐具

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：150.00 元

论证专家签字：

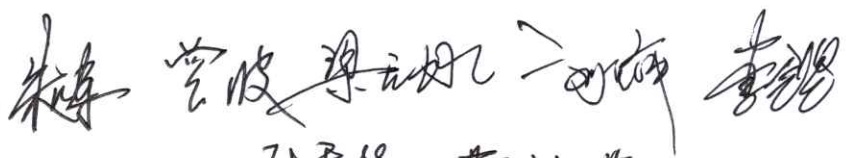

监督小组签字：

时间：2024年3月22日

成人双向阶梯

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：2300.00 元

论证专家签字：
监督小组签字：

时间：2024年3月22日

放大镜

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：10.00 元

论证专家签字：

程 常波 梁云儿 刘峰 李强

监督小组签字：

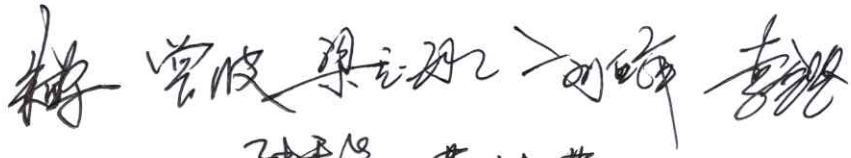
陈彦华 黄法莲

时间：2024 年 3 月 22 日

洗漱套装

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：200.00 元

论证专家签字：


监督小组签字：

时间：2024年3月22日

洗澡椅

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：165.00 元

论证专家签字：

监督小组签字：

时间：2024 年 3 月 22 日

扶手

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：500.00 元

论证专家签字：

监督小组签字：

时间：2024年3月22日

秒表

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：50.00 元

论证专家签字：

朱林 常波 梁红妃 王明 李强

监督小组签字：

陆东平 黄法章

时间：2024年3月22日

握力器 2 个

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：200.00 元

论证专家签字：

朱保 曾波 梁立红 何敏 李锐

监督小组签字：

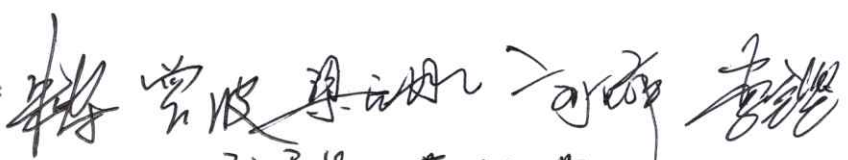

陆志华 黄法莲

时间：2024 年 3 月 22 日

老花镜

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型


参考价格：100.00 元

论证专家签字：
监督小组签字：
时间：2024 年 3 月 22 日

身高体重仪

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：2400.00 元

论证专家签字：

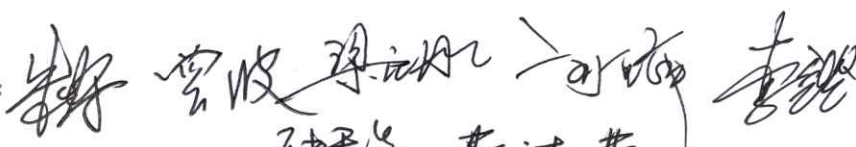

监督小组签字：

时间：2024 年 3 月 22 日

坐式体重秤

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：2800.00 元

论证专家签字：
监督小组签字：

时间：2024年3月22日

人体成分分析仪参数

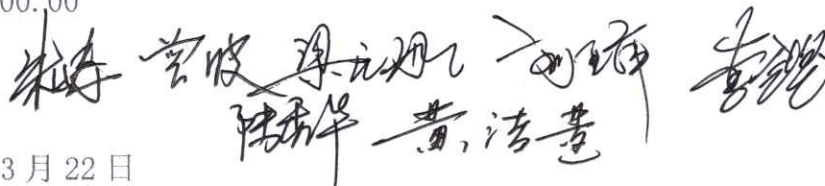
- 1、工作原理：多频率生物电阻抗测量法（BIA 法）
- 2、测量部位：5 个节段测量（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）
- 3、测量电极：8 点接触式电极
- 4、测量频率：5kHz、50kHz、250kHz
- ★5、测量电流： $\leq 350 \mu A$
- 6、测量时长：约 40 秒
- ★7、显示屏幕： ≥ 7 寸 LCD 液晶触摸屏，分辨率 800*480ppi
- 8、输出指标：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估及结果打分等。
- 9、肌肉评估：对上下肢分别进行肌肉平衡和不平衡评估；对上下肢分别进行肌肉不足、正常和发达评估。
- 10、肥胖分析：采用体脂肪量、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段四个指标进行肥胖综合评估，并提供正常范围参考值。
- 11、体型判定：隐形肥胖、脂肪过量、肥胖、低体重、标准体型、超重肌肉型、低脂肪低体重、低脂肪肌肉型、运动员型九种体型判定，并采用坐标轴图示。
- 12、支持两种输出报告模式：专用模板报告和通用 A4 打印纸报告。
- 13、运动处方：提供日常、低、中、高四种不同运动量的推荐建议方案。
- 14、通信接口：USB, RS-232
- ★15、阻抗测量范围：20-1200 Ω ，误差 $\leq 3\%$ ，提供检测报告证明材料。
- ★16、体重测量范围：5-250kg
- 17、身高支持输入范围：90-220cm
- ★18、年龄支持输入范围：1-99 岁
- 19、提供医疗器械注册证；
- 20、提供电脑管理软件及相应著作权证，便于系统上位机电脑控制和系统对接。

参考价格：50000.00

论证专家签字：

监督小组签字：

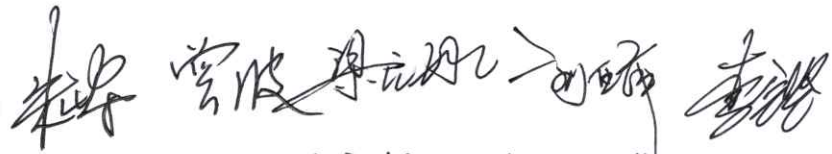
时间：2024 年 3 月 22 日



皮尺（软尺）

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：10.00 元

论证专家签字：

监督小组签字：


时间：2024年3月22日

贴纸 10 张

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：100.00 元

论证专家签字： 

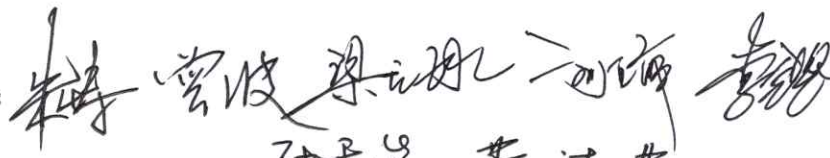
监督小组签字： 

时间：2024 年 3 月 22 日

量杯

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：50.00 元

论证专家签字：

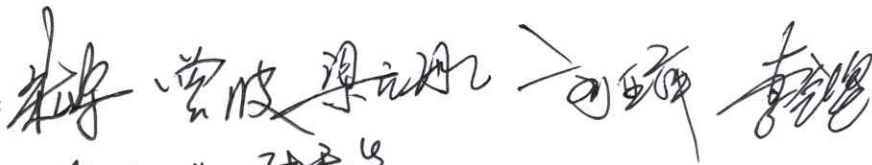
监督小组签字：

时间：2024年3月22日

小勺

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：10.00 元

论证专家签字： 

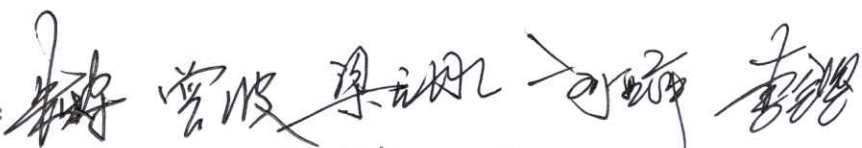
监督小组签字： 


时间：2024年3月22日

听力音叉

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：60.00 元

论证专家签字：

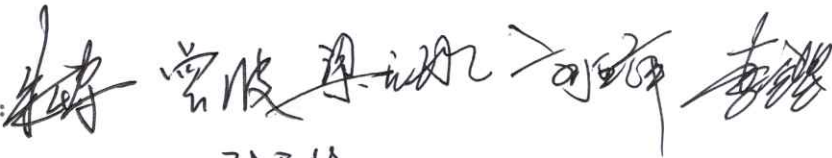
监督小组签字：

时间：2024 年 3 月 22 日

视力表

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：300.00 元

论证专家签字：

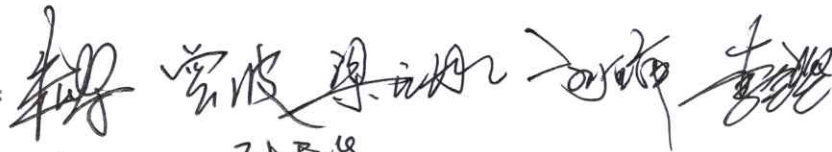
监督小组签字：


时间：2024年3月22日

平板电脑 Pad

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：3000.00 元

论证专家签字：

监督小组签字：

时间：2024 年 3 月 22 日

打印复印传真机

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：1000.00 元

论证专家签字：朱睿 岑波 梁进 孔可 李强

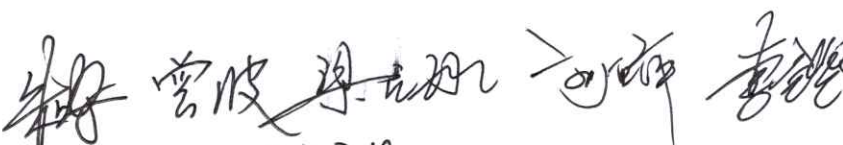
监督小组签字：黄法基 陆平

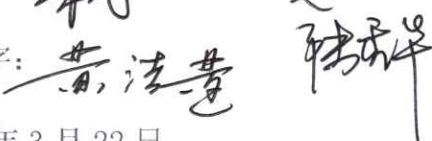
时间：2024年3月22日

可移动输液架 10 个

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：3350.00 元

论证专家签字：

监督小组签字：

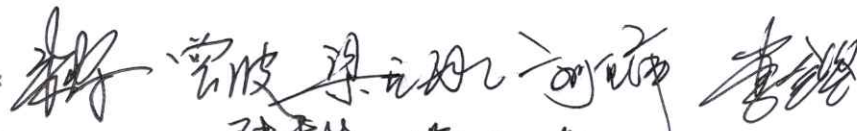
时间：2024 年 3 月 22 日

艾灸排烟系统参数

- 1、排烟主机：4000 风量，防油烟机芯，镀锌铁材质焊接制作而成。
规格：电压 220V，功率 1.37KW、转速 1350 转/分钟，噪音≤50db，适用于 5-6 个床位。
- 2、排烟主机 3000 风量，设有大小档位 2 速调速功能。电压 220V，功率 1.1KW、转速 1250 转/分钟，噪音≤50db，适用于 4 个床位。
- 3、排烟主机：2200 风量，防油烟机芯，镀锌铁材质焊接制作而成。
规格：电压 220V，功率 0.55KW，转速 1250 转/分钟，噪音≤50db，设有大小档位 3 调速功能。适用于 3 个床位。
- 4、排烟主机：1200 风量，防油烟机芯，镀锌铁材质焊接制作而成。
规格：电压 220V，功率 0.25KW、转速 1150 转/分钟，噪音≤50db，设有大小档位 3 速调速功能。适用于 2 个床位。
- 升降系统：升降电机外壳 1mm 厚镀锌铁壳焊接；电压 220v，功率 14w，承载重量 10 公斤；静音。
- 合金轨道：采用铝合金材质，长 1800mm，宽 27mm，高 25mm，厚 2mm。可手动使排烟罩子前后随意移动定位。
- 7、遥控系统：电压 220v 功率 15w，长 7cm 宽 5cm 厚 4cm，有效远程遥控距离 5 米。
- 8、排烟罩：采用 4mm 厚的高透明亚克力环保材料，耐高温 200 度，尺寸是长 90cm，宽 60cm，高 18cm，中心孔直径 16cm。
- 9、吸烟喉：采用 ABS 环保材料一次注塑成型。规格：长 400mm，直径 200mm。内置调节阀可随意调节风量大小。
- 10、软管配置：双层金属软管，耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。长 2000mm，管口直径 160mm，可灵活来回伸缩功能，确保排烟通畅，不易折坏。

参考价格：29400.00 元

论证专家签字：



监督小组签字：



时间：2024 年 3 月 22 日

空调 6 套

满足现有临床科室需要，符合市场主流机型

参考价格：18000.00 元

论证专家签字：

傅 宏波 梁 礼 斌 刘 伟 李 强

监督小组签字：

陆 东 华 黄 法 章

时间：2024 年 3 月 22 日